

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026


CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Fio de Sutura

Nome Comercial: Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix

Nº Registro ANVISA: 80083650084

Matéria-Prima: vide imagem ilustrativa dos componentes abaixo:

Imagem ilustrativa dos componentes				
	Item	Descrição	Matéria-prima	Norma
	1	Fio de Sutura UHMWPE Branco ou Fio de Sutura UHMWPE Branco/Azul	UHMWPE	NBR 13904
	2	Agulha curva para Sutura	Aço Inox 420B	NBR 13911
		Agulha reta para Sutura	Aço Inox F138	ASTM F138

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO)

Validade: 5 anos

Dispositivo Médico de Uso Único – PROIBIDO REPROCESSAR

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO












Os modelos comerciais que compõem a família da Sutura cirúrgica agulhada Suturfix são classificados como dispositivo médico implantável invasivo cirurgicamente de uso em longo prazo.

O fio da sutura cirúrgica é de origem sintética, fabricada com multifilamento trançado de Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE) de alta resistência, não absorvível e com agulha, estéril. Possui número cirúrgico 2 e 2-0 (número métrico 5 e 3, respectivamente) e vários comprimentos: 45 cm, 75 cm e 90 cm; atende aos requisitos USP (United States Pharmacopeia) e NBR 13904.

A agulha curva é fabricada com Aço Inoxidável 420B, atraumática, furada, curva, cilíndrica, ½ círculo, com 20 e 25 mm de comprimento. A agulha reta é fabricada com Aço Inoxidável F138, atraumática, furada, reta, cilíndrica, com 255 mm de comprimento. Atendem aos requisitos da norma NBR 13911 e ASTM F138.




	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

A seguir são apresentadas as características dos modelos comerciais que compõem a família da Sutura cirúrgica agulhada Suturfix:

Código Descrição	Imagem Ilustrativa	Cor do Fio	N° cirúrgico	Ø do Fio	Tipo/Qtd de Agulha	Comprimento do Fio
0234130-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 45 B		Branco	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	45 cm
0234130-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 75 B		Branco	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	75 cm
0234130-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 90 B		Branco	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	90 cm
0234131-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 45 B/A		Branco/Azul	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	45 cm
0234131-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 75 B/A		Branco/Azul	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	75 cm
0234131-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 90 B/A		Branco/Azul	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	90 cm
0234150-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 45 B		Branco	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	45 cm
0234150-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 75 B		Branco	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	75 cm
0234150-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 90 B		Branco	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	90 cm
0234151-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 45 B/A		Branco/Azul	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	45 cm

Código	Descrição	Imagem Ilustrativa	Cor do Fio	N° cirúrgico	Ø do Fio	Tipo/Qtde de Agulha	Comprimento do Fio
0234151-075	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 75 B/A		Branco/Azul	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	75 cm
0234151-090	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 90 B/A		Branco/Azul	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	90 cm
0234230-045	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 45 B		Branco	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	45 cm
0234230-075	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 75 B		Branco	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	75 cm
0234230-090	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 90 B		Branco	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	90 cm
0234231-045	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 45 B/A		Branco/Azul	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	45 cm
0234231-075	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 75 B/A		Branco/Azul	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	75 cm
0234231-090	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 90 B/A		Branco/Azul	USP#2-0	0,30 mm	 20 mm Aço Inox 420B	90 cm
0234250-045	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 45 B		Branco	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	45 cm
0234250-075	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 75 B		Branco	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	75 cm


	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

Código	Descrição	Imagem Ilustrativa	Cor do Fio	N° cirúrgico	Ø do Fio	Tipo/Qtd de Agulha	Comprimento do Fio
0234250-090	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 90 B		Branco	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	90 cm
0234251-045	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 45 B/A		Branco/Azul	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	45 cm
0234251-075	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 75 B/A		Branco/Azul	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	75 cm
0234251-090	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 90 B/A		Branco/Azul	USP#2	0,5 mm	 25 mm Aço Inox 420B	90 cm
0234241-045	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/2 AG 255MM USP 2-0 - 45 B/A		Branco/Azul	USP#2-0	0,30 mm	 255 mm Aço Inox F138	45 cm
0234241-075	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/2 AG 255MM USP 2-0 - 75 B/A		Branco/Azul	USP#2-0	0,30 mm	 255 mm Aço Inox F138	75 cm
0234241-090	- SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/2 AG 255MM USP 2-0 - 90 B/A		Branco/Azul	USP#2-0	0,30 mm	 255 mm Aço Inox F138	90 cm

2. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Os modelos comerciais que compõem a família da Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix são disponibilizados para comercialização unitariamente nas seguintes dimensões:

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0234130-045	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 45 B
	0234130-075	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 75 B
	0234130-090	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 90 B
	0234131-045	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 45 B/A
	0234131-075	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 75 B/A
	0234131-090	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 90 B/A
	0234150-045	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 45 B
	0234150-075	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 75 B
	0234150-090	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 90 B
	0234151-045	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 45 B/A
	0234151-075	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 75 B/A
	0234151-090	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 90 B/A
	0234230-045	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 45 B
	0234230-075	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 75 B
	0234230-090	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 90 B
	0234231-045	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 45 B/A
	0234231-075	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 75 B/A
	0234231-090	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 90 B/A
	0234250-045	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 45 B
	0234250-075	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 75 B
	0234250-090	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 90 B
	0234251-045	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 45 B/A
	0234251-075	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 75 B/A
	0234251-090	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 90 B/A
	0234241-045	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/2 AG 255MM USP 2-0 - 45 B/A
	0234241-075	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/2 AG 255MM USP 2-0 - 75 B/A
	0234241-090	SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/2 AG 255MM USP 2-0 - 90 B/A

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

A correta seleção dos modelos comerciais é responsabilidade do cirurgião que também é responsável pela técnica adotada, devendo este estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado.

O êxito do procedimento está ligado à correta seleção, posicionamento e fixação do nó que é de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais os implantes a serem utilizados. Está vinculado também o rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico responsável.

2.1. Acessórios

A família da Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix não possui acessórios ou componentes ancilares.

3. COMPOSIÇÃO

O fio de sutura e a agulha são as partes que entram em contato com o paciente, entretanto, somente o fio permanece implantado. A agulha é descartada após a implantação do fio, como recomendado no item “Descarte”.

Os materiais selecionados para a fabricação dos componentes do produto apresentam as propriedades requeridas para atingir o desempenho pretendido para a família da Sutura cirúrgica agulhada Suturfix. Essa seleção considerou fatores como a biocompatibilidade e propriedades físico-químicas e mecânicas requeridas para o produto.

O Fio de Sutura é fabricado com Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE), conforme a norma NBR 13904 - Fios para sutura cirúrgica. Este tipo de fio vem sendo utilizado no mercado cirúrgico a mais de 10 anos, sendo comprovada sua utilização e biocompatibilidade, através de diversas literaturas clínicas e científicas.







A Agulha curva é fabricada com Aço Inox 420B, conforme norma NBR 13911 - Instrumental cirúrgico - Material metálico - Especificações para aços inoxidáveis conformados. A agulha reta é fabricada com Aço Inox F138 conforme norma ASTM F138 - Standard Specification for Wrought 18Chromium 14Nickel 2.5Molybdenum Stainless Steel Bar and Wire for Surgical Implants (UNS S31673).

Ambas as agulhas não devem ser implantadas.






	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

4. INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE

Os fios de sutura com agulha curva são indicados para uso em cirurgias ortopédicas para aproximação e/ou ligação das partes moles. Na tabela a seguir estão relacionados os fios de sutura com agulha curva que atendem a esta indicação.

Modelos Comerciais	Nº cirúrgico	Agulha
0234130-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 45 B	USP#2-0	 20 mm
0234130-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 75 B	USP#2-0	 20 mm
0234130-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 90 B	USP#2-0	 20 mm
0234131-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 45 B/A	USP#2-0	 20 mm
0234131-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 75 B/A	USP#2-0	 20 mm
0234131-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2-0 - 90 B/A	USP#2-0	 20 mm
0234150-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 45 B	USP#2	 25 mm
0234150-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 75 B	USP#2	 25 mm
0234150-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 90 B	USP#2	 25 mm
0234151-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 45 B/A	USP#2	 25 mm
0234151-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 75 B/A	USP#2	 25 mm
0234151-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 90 B/A	USP#2	 25 mm
0234230-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 45 B	USP#2-0	 20 mm




	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

Modelos Comerciais	N° cirúrgico	Agulha
0234230-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 75 B	USP#2-0	 20 mm
0234230-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 90 B	USP#2-0	 20 mm
0234231-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 45 B/A	USP#2-0	 20 mm
0234231-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 75 B/A	USP#2-0	 20 mm
0234231-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2-0 - 90 B/A	USP#2-0	 20 mm
0234250-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 45 B	USP#2	 25 mm
0234250-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 75 B	USP#2	 25 mm
0234250-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 90 B	USP#2	 25 mm
0234251-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 45 B/A	USP#2	 25 mm
0234251-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 75 B/A	USP#2	 25 mm
0234251-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/ 2 AGULHAS USP 2 - 90 B/A	USP#2	 25 mm

Os fios de sutura com agulha reta são utilizados em reparo do menisco. Pode ser realizado com técnica aberta ou artroscópica, de dentro para fora. Indicadas para o reparo de lesão periférica longitudinal aguda de 1 a 2 cm. Em pacientes jovens, pode ser reparada em conjunto com a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA).

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

Na tabela abaixo estão relacionados os fios de sutura com agulhas retas, que atendem esta indicação.

Código Descrição	Nº cirúrgico	Tipo/Qtde de Agulha
0234241-045 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/2 AG 255MM USP 2-0 - 45 B/A	USP#2-0	 255 mm
0234241-075 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/2 AG 255MM USP 2-0 - 75 B/A	USP#2-0	 255 mm
0234241-090 - SUTURFIX, SUTURA CIR. TRANÇADA C/2 AG 255MM USP 2-0 - 90 B/A	USP#2-0	 255 mm

4.1. Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de Ação

A ação do fio de sutura é a de estabilizar as partes moles e proporcionar uma colocação segura em relação às estruturas adjacentes.

5. PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

5.1. Contraindicações

- Cirurgia cardiovascular;
- Pacientes que não apresentem um bom estado de saúde geral podem comprometer a velocidade do processo de cicatrização;
- Pacientes obesos, pois a gordura não tem um rico suprimento sanguíneo, tornando todos os tecidos mais vulneráveis ao trauma e a infecção;
- Pacientes desnutridos associados com doenças crônicas ou deficiências específicas podem prejudicar o processo de cicatrização;
- Pacientes desidratados, o que resulta em desequilíbrio eletrolítico podendo afetar a função cardíaca, renal, metabolismo celular, oxigenação do sangue, e a função hormonal, o que pode prejudicar o processo de cura;
- Fornecimento de sangue inadequado no local da lesão, tais como má circulação em paciente diabético ou com arteriosclerose vascular pode minimizar, e até mesmo deter o processo de cicatrização;

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

- Pacientes que apresentem sistema imunológico debilitado ou aqueles que foram recentemente submetidos à quimioterapia, como também os pacientes que tomaram altas doses de esteroides catabólicos prolongados;
- Pacientes que apresentem reação alérgica ao material de polietileno, o que pode interferir no processo de cicatrização. Portanto, testes deverão ser feitos para evidenciar tal situação.

5.2. Precauções e Advertências

- O uso do produto deve ser feito por equipes cirúrgicas especializadas, com total domínio da técnica a ser utilizada, e do tipo do nó a ser executado;
- Excesso de tração sobre o fio de sutura pode ocorrer deformação plástica, causando falência precoce ou ruptura;
- Se o produto for armazenado, manipulado inadequadamente ou exposto à luz solar ou umidade, poderá ocorrer danos ao implante, ou ao rótulo do produto, acarretando em ruptura do fio, ou a agulha se desprender do fio de sutura e ainda perda de informações e perda da esterilização acarretando problemas ao paciente;
- Escolha inadequada do tamanho do fio, ou da técnica cirúrgica pode provocar tensões excessivas ao produto;
- O produto foi desenvolvido para aproximação e/ou ligação das partes moles e reparo do menisco, sendo que a utilização para fixação de outras estruturas representa um risco e está contraindicada;
- Deve ocorrer técnica cirúrgica precisa, pois dela depende os resultados clínicos e a durabilidade do fio de sutura;
- Pode ocorrer ruptura do fio ou soltura das partes moles, quando carregado além de sua capacidade funcional;
- A agulha é utilizada pelo cirurgião para penetrar as partes moles ou o menisco, e fazer avançar o fio de sutura à sua localização desejada, após sua utilização deve ser descartada em local apropriado para produtos perfurocortantes;
- As agulhas não devem ser conformadas;
- Este tipo de procedimento cirúrgico apresenta riscos de lesões vasculares, neurais, entre outros;

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

- Pacientes cuja atividade exija esforços ou práticas esportivas durante o período pós-operatório, contrariando as informações médicas, podem contribuir fortemente para a falha do produto;
- Pacientes que tendem a desobedecer às orientações médicas e restrições pós-operatórias, como crianças, idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos, representam um risco maior para falha, devendo ter um acompanhamento especial;
- Podem ocorrer complicações pós-operatórias caso o item Contraindicações não for levado em consideração;
- O paciente deve fazer acompanhamento médico periódico para checar as condições do fio e do tecido adjacente;
- O fio de sutura não deve ser utilizado com dispositivos médicos de outros fabricantes, pois o acabamento superficial destes (cortante ou com rebarbas) pode comprometer o desempenho do fio, causando ruptura;
- A abertura da embalagem deverá ser feita somente por pessoal habilitado a realizar esse procedimento, para que não ocorra dano ao material, perda da esterilização ou infecção cruzada;
- Quedas ou esmagamento sobre superfícies duras podem causar danos ao produto. Dessa forma é necessário que o operador realize uma inspeção para verificar a integridade do produto, na abertura da embalagem e se for observado alguma anormalidade, o produto deverá ser descartado;
- Não utilize o produto se estiver com a embalagem violada ou o prazo de esterilização estiver vencido;
- Manipule com cuidado, não utilize instrumentais que possam danificar a agulha ou o fio, isso pode contribuir para a perda de resistência dos mesmos;
- O cirurgião deve ter domínio sobre a confecção do nó, pois este item é fundamental para que ocorra suporte suficiente até a completa cicatrização tecidual;
- Tal como em todas as técnicas de sutura, o fio de sutura destina-se a aproximar os tecidos moles ou reparar o menisco, durante o período de tempo adequado à reconstrução biológica dos mesmos. O fio de sutura não se destina a proporcionar integridade biomecânica indefinida;
- Produto Médico de Uso Único, Não Reutilizar - PROIBIDO REPROCESSAR;

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

- O produto nunca deve ser reutilizado, embora possa parecer não estar danificado, as tensões prévias que o mesmo foi submetido, pode originar imperfeições que reduziriam o tempo de vida útil do produto num reimplante e/ou provocar infecção e rejeição;
- Produto Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno e deve ser manipulado corretamente de forma a evitar a perda da esterilização ou infecção cruzada;
- É recomendado que os fios sejam desembalados imediatamente antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar intactos a configuração original, o acabamento da superfície, e esterilidade, e convém que os mesmos sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições;
- As agulhas não devem ser implantadas. Seu descarte deve seguir as orientações indicadas no item “Descarte”;
- Data de fabricação, prazo de validade e número de lote: vide rótulo;
- Os produtos foram desenvolvidos para utilização seguindo as precauções e advertências acima, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico que suporte o seu uso.

5.3. Possíveis Efeitos Adversos

- Riscos de lesões vasculares, viscerais e neurais;
- Risco de infecção;
- Risco de ruptura do fio de sutura ou das partes moles e
- Risco de falha na interface entre fio de sutura e agulha.

5.4. Informações ao usuário do produto

A equipe cirúrgica responsável deve instruir o paciente sobre:

- As restrições e precauções pós-operatórias referente às atividades físicas, suporte de peso, antes da completa cicatrização das partes moles. Pois o não cumprimento das instruções médicas pode levar o fio à ruptura, ou soltura, acarretando em cirurgia de revisão;
- Os riscos potenciais de falha quando o implante for utilizado em pacientes que possam desobedecer às orientações médicas, os cuidados e as restrições pós-

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

operatórias, como crianças, idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos;

- A compreensão do paciente que o implante é usado com a finalidade de fixação enquanto as partes moles ou menisco não estejam totalmente integradas e, portanto, pode romper, deformar ou soltar, se sofrer esforços, atividades excessivas e carga precoce dentro do período de restrição definido pelo cirurgião;
- O aumento do risco de complicações pós-operatórias em pacientes com obesidade (pois a gordura não tem um rico suprimento sanguíneo, tornando todos os tecidos mais vulneráveis ao trauma e a infecção), podendo acarretar soltura ou falência prematura do implante;
- A necessidade de acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante e dos tecidos adjacentes;
- A necessidade de cirurgia de revisão, em casos de soltura do implante;
- A durabilidade dos implantes é afetada por numerosos fatores biológicos, biomecânicos e extrínsecos, que limitam a sua vida útil. Portanto, é estritamente necessária a obediência as indicações, contraindicações, precauções e advertências para este produto, os quais são essenciais para maximizar o tempo de uso pretendido;
- As informações listadas neste tópico “Informações ao usuário do produto” e no tópico “Possíveis Efeitos Adversos”.

5.5. Instruções de Uso

- Somente pessoas devidamente capacitadas devem manipular este produto, e em ambientes adequados (centros de materiais e salas cirúrgicas) para que não ocorra dano ao material ou perda da esterilização, acarretando infecção ao paciente;
- Caso ocorram armazenamento e manipulação errônea, antes ou durante o procedimento cirúrgico, como por ex. quedas ou atritos, os fios agulhados podem sofrer danos mecânicos, consequentemente falência prematura e também perda da esterilização;

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

- São de responsabilidade do cirurgião ou equipe cirúrgica o correto posicionamento do paciente, a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada e do tipo de nó a ser executado;
- Excesso de tração sobre o fio de sutura pode ocorrer deformação plástica, causando falência precoce ou ruptura;
- O fio de sutura não deve ser utilizado com dispositivos médicos de outros fabricantes, pois o acabamento superficial destes (arestas cortantes ou com rebarbas) pode comprometer o desempenho do fio, causando ruptura;
- Devem estar asseguradas as condições para que ocorra a cirurgia altamente asséptica. A avaliação clínica e por imagem (radiografia, ressonância magnética, tomografia, etc.) pré-operatória do paciente deve ser conclusiva.

Instrução de uso durante o procedimento cirúrgico:

- ✓ Com a porta agulha, retirar o fio de sutura da embalagem, através da apreensão da agulha, manipular com cuidado;
- ✓ Transpassar o fio na região desejada;
- ✓ Realizar a manobra nos fios para executar o nó conforme a escolha do cirurgião;
- ✓ Repetir essas etapas, quantas vezes forem necessários;
- ✓ Limpar o local e
- ✓ Fechar o acesso cirúrgico.
- A vida útil do produto é caracterizada pelo tempo de uso pretendido, se bem planejado, corretamente fixado e em condições ideais, o tempo de permanência é até que ocorra a reconstrução das partes moles ou do menisco, na qual após esse período recomenda-se a retirada do fio. Entretanto em caso de ausência ou problemas com a reconstrução, estas podem representar um risco de falha do fio de sutura, por excesso de solicitação mecânica;
- Caso ocorra soltura do fio, das partes moles ou do menisco, poderá ser necessária a realização de cirurgia de revisão, diante dessa possibilidade o cirurgião responsável deverá instruir o paciente quanto a importância do acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante e do tecido adjacente;
- É importante a compreensão que a vida útil do produto está condicionada às respostas ideais, ou seja, depende da interação de diversos fatores como: a responsabilidade do fabricante em relação ao projeto adequado do produto, responsabilidade do profissional como técnica cirúrgica precisa, e outros fatores

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

que dependem do paciente, como resposta fisiológica, a condição clínica, conduta do paciente em relação ao aumento de peso, porte de cargas pesadas e adoção de alto nível de atividade física.

5.6. Manuseio

- O produto deve ser mantido em suas embalagens originais estéreis até o momento de sua utilização, sendo que a abertura da embalagem para utilização cirúrgica e o manuseio do produto deverá ser realizado por pessoal habilitado para este procedimento.

5.7. Armazenamento

- Para o armazenamento, recomenda-se local seco e arejado, sem exposição à incidência de luz, a umidade ou a substâncias contaminantes;
- Os implantes não podem ser armazenados diretamente sobre o chão. Assim, recomenda-se a utilização de prateleiras com altura mínima de 20cm;
- Armazenar em temperatura não superior à 55°C e umidade entre 35% e 65% UR.

5.8. Transporte

- O produto deve ser transportado adequadamente, evitando-se quedas e atritos que possam danificar a estrutura e a superfície do produto.

5.9. Esterilização

Os modelos comerciais que compõem a família da Sutura cirúrgica agulhada Suturfix são comercializados na condição de produto Estéril, devendo ser retirado de sua embalagem original por pessoal habilitado, somente no ambiente cirúrgico estéril e ser utilizado imediatamente.

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

O método de esterilização utilizado é a Esterilização por Óxido de Etileno - ETO em câmara apropriada, previamente validada, seguindo os parâmetros e procedimentos estabelecidos no protocolo de validação e na norma NBR ISO 11135 - Esterilização de produtos de atenção à saúde - Óxido de etileno - Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde.

- Produto Estéril – Não reesterilizar;
- Prazo de Validade: 05 anos da data de fabricação;
- Não utilize o produto caso a embalagem esteja violada ou o prazo de validade da esterilização esteja vencido;
- Produto Médico de Uso Único, Não Reutilizar - PROIBIDO REPROCESSAR;
- O produto nunca deve ser reutilizado, embora possa parecer não estar danificado, as tensões prévias a que os mesmos foram submetidos podem originar imperfeições que reduziram o tempo de vida útil do produto num reimplante;
- Data de fabricação, prazo de validade e número do lote: vide rótulo.

5.10. Risco de Contaminação

Considerando que o produto é um dispositivo médico implantável, ou seja, está em contato com tecidos e fluídos corpóreos, nos casos da explantação, os mesmos devem ser tratados como material sujeito à contaminação biológica e transmissão de doenças virais.

De modo a minimizar esses riscos, devem-se adotar as normatizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis, para evitar contaminação ao meio ambiente ou às pessoas que tenham contato com o produto explantado.

5.11. Descarte

Após a utilização das agulhas, estas devem ser descartadas em local próprio para material perfurocortante, para que não ocorra contaminação do meio ambiente. Antes, porém, recomenda-se que o produto seja entortado para descaracterizá-lo, evitando assim sua reutilização. Deve-se ter cuidado no manuseio das agulhas para que não ocorram lesões ao operador.

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

Os fios de sutura explantados ou considerados inadequados para o uso devem ser descartados, entretanto, recomenda-se que o produto seja descaracterizado, para tal, os fios podem ser cortados.

Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11/08/06, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados.

Implantes estéreis que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, ou que forem removidos de seus pacientes e que não tenham objetivos de estudos e/ou análises posteriores devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar.

Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado devem assegurar a completa descaracterização do mesmo, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como, os métodos e procedimentos de descarte utilizados. Entretanto, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores recomenda que tais produtos sejam deformados mecanicamente e/ou cortados. Em seguida, devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.

O fio e a agulha devem ser descartados em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes (RDC 222 de 2018 - Resíduo Hospitalar).

Produto Médico de Uso Único – Não Reutilizar, PROIBIDO REPROCESSAR.

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO DISPOSITIVO MÉDICO

6.1. Embalagem

Os modelos comerciais, que compõem a família da Sutura cirúrgica agulhada Suturfix, são disponibilizados para comercialização embalados unitariamente, na condição de produto Estéril.

Os implantes são acondicionados em embalagem de cartolina e logo em seguida, embalados em Steribag (embalagem primária - fabricado em papel grau cirúrgico, filme

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

laminado de poliéster e polipropileno com indicadores de processo, isento de furos e sem corantes) atóxico, permitindo contato com produtos hospitalares.

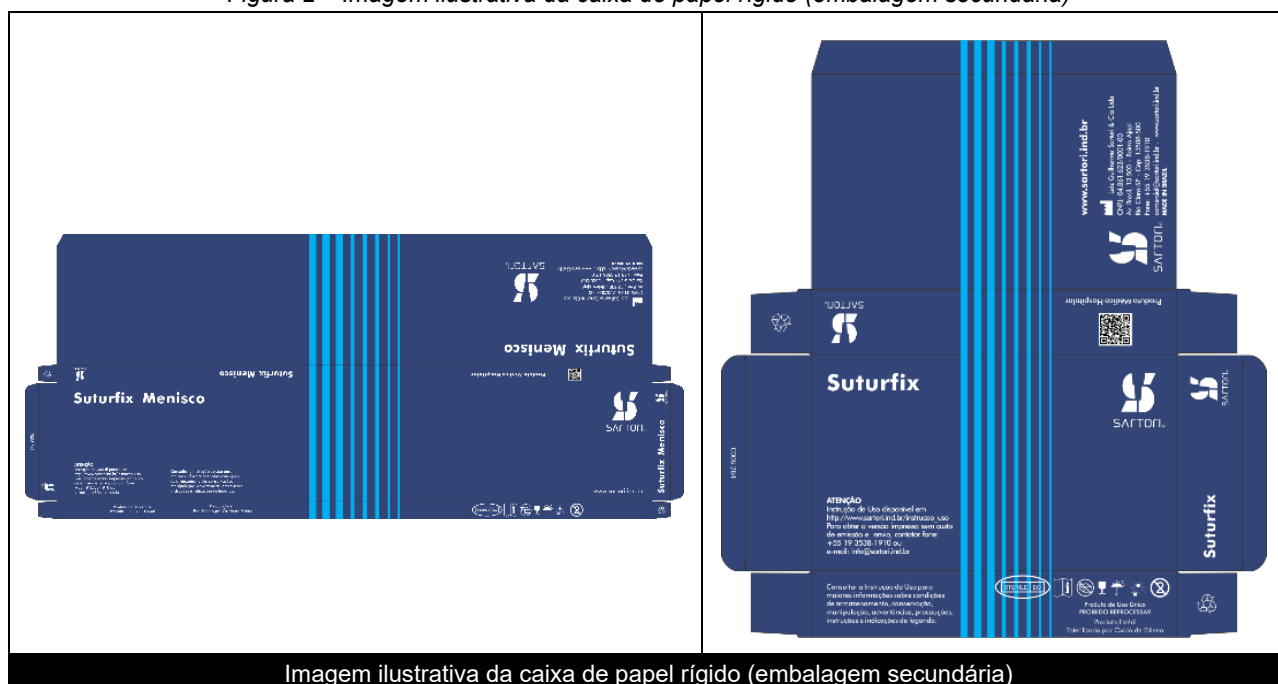
A embalagem de Steribag é acondicionada em caixa de papel rígido (embalagem secundária).

Dentro da embalagem externa, segue 5 vias da etiqueta de rastreabilidade e um alerta de instrução de uso, e sobre a mesma contém um rótulo, com as informações necessárias para a identificação do produto, como código, descrição, número de lote, data de validade, número do registro do produto na ANVISA etc., conforme imagens ilustrativas a seguir:

Figura 1 – Imagem ilustrativa da embalagem primária do produto



Figura 2 – Imagem ilustrativa da caixa de papel rígido (embalagem secundária)



	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

Figura 3 – Imagem ilustrativa do Rótulo

REF	0234150-045	LOT	20810S
QTD	1	15/05/2024	15/05/2029
SUTUREFIX, SUTURA CIR. TRANCADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 45 B			
MD			
REF	0234150-045	LOT	20810S
QTD	1	15/05/2024	15/05/2029
SUTUREFIX, SUTURA CIR. TRANCADA C/ 1 AGULHA USP 2 - 45 B			
Material: ACO INOX 420B / UHMWPE			
Nome Comercial: SUTURA CIRURGICA			
AGULHADA SUTUREFIX			
Nome Técnico: FIO DE SUTURA			
LOT			
Registro Anvisa: 80083650084			
Instruções de uso, ver Rev XX			
Responsável Técnico			
Sérgio R.A. Oliveira			
CREA/SP: 5070105936			
UDI	(01)07909700167040(17)290515(10)20810S		

Na embalagem do produto também constam informações de como obter a Instrução de Uso de forma eletrônica ou impressa e dados para contato. As informações do produto são importantes para a rastreabilidade e acompanhamento e/ou notificação de eventos adversos à ANVISA.

O produto estéril não pode ser reesterilizado e nem reutilizado, pois se trata de produto de uso único, sendo proibido de reprocessar.

Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto.

6.2. Rastreabilidade

A rastreabilidade da Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix é realizada por meio das informações apresentadas nas etiquetas de rastreabilidade, nas quais estão disponíveis informações a respeito do fabricante, nome e modelo comercial do produto, número de lote, código do produto e o número de registro Anvisa, possibilitando traçar o caminho reverso

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

até a fabricação do produto. Desse modo é possível verificar a matéria-prima, seus fornecedores e informações sobre os controles de qualidade realizados do início ao fim do processo de fabricação.

Na embalagem dos modelos comerciais são fornecidas 5 unidades de etiqueta de rastreabilidade e sua fixação é obrigatória no prontuário Clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documentação fiscal que gera a cobrança.

Figura 4 - Modelo de etiqueta de rastreabilidade




6.3. Legenda dos símbolos contidos na rotulagem

As simbologias apresentadas no rótulo dos dispositivos médicos estão ilustradas no Quadro abaixo, em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 15223-1.

Quadro – Símbolos segundo ABNT NBR ISO 15223-1

	Número de catálogo (código do produto embalado)
	Quantidade do produto embalado
	Código de remessa (número de lote do produto embalado)
	Data de Fabricação
	Usar até a data (validade)

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

	Esterilizado com Óxido de Etileno
	Não Reusar
	Armazenar em temperatura não superior à 55°C e umidade entre 35% e 65% UR
	Consultar Instruções de uso ou consultar instruções eletrônicas de uso
	Fabricante
	Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso
	Proteger de luz solar
	Manter seco
	Frágil, manusear com cuidado
	Dispositivo médico
	Identificador único do dispositivo

6.4. Alerta de Instrução de Uso

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso.

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

Figura 5 – Modelo de Alerta de Instrução de Uso

ALERTA DE INSTRUÇÕES DE USO

Conforme Resolução RDC 751 de 15.09.2022, que estabelece requisitos para disponibilização de Instrução de Uso em formato não impresso de dispositivos médicos, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.

As Instruções de Uso estão disponíveis em: https://sartori.ind.br/instrucao_uso

Para a visualização dos arquivos utilize o software Adobe Acrobat Reader. As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do número de Registro/ Notificação ANVISA e respectivo nome comercial (descrição do registro).

Todas as Instruções de Uso possuem o Nº do Registro/Notificação ANVISA e a revisão na primeira página do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso, informada no rótulo do produto.

Para Instrução de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar sem custo adicional (inclusive de envio), por meio do telefone +55 19 3538-1910 ou do e-mail: info@sartori.ind.br.

(FSQ 095.07.01)

6.5. Reclamação e Atendimento ao Cliente

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores através dos dados para contato contido nas instruções de uso e rótulo na embalagem do produto.

Para o envio de dispositivos médicos explantados ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do implante.

A embalagem deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto médico, relacionadas às condições de manuseio, métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote.

6.6. Notificação de eventos adversos

Na ocorrência de qualquer evento adverso ou a necessidade de registrar queixa técnica, a SARTORI e a Anvisa devem ser notificadas por meio dos seguintes canais:

- SARTORI: <https://sartori.ind.br>
- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail: info@sartori.ind.br
- Sistema NOTIVISA (Anvisa): www.gov.br/anvisa

	INSTRUÇÃO DE USO Sutura Cirúrgica Agulhada Suturfix	Código:	IU.0084
		Revisão:	04
		Data:	20/10/2026

Fabricante/Detentor do Registro:

LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA LTDA.

Avenida Brasil, nº 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP: 13508-500 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910

e-mail: info@sartori.ind.br

Registro ANVISA nº: 80083650084

Responsável Técnico: Engº Sergio Roberto Alves de Oliveira

CREA/SP: 5070105936

HISTÓRICO DE REVISÕES INSTRUÇÃO DE USO		
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
04	Adequação da Instrução de Uso ao novo template.	20/10/2026